

Human VEGF R1/Flt-1 ELISA Kit

目录号

CHE0152

CHE0152

规格

96 Tests

48 Tests



Human VEGF R1/Flt-1 ELISA Kit

本试剂盒用于定量检测人血清、血浆或细胞培养上清液等样本中天然和重组 VEGF R1/Flt-1 浓度。**使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分**，如有任何疑问请与北京四正柏生物科技有限公司联系，公司将为您提供强有力的技术支持。

仅供研究，不用于临床诊断。

目录

简介.....	2
检测原理.....	4
试剂盒组成.....	5
储存条件.....	6
其它实验材料.....	7
注意事项.....	7
样品收集、处理及保存方法.....	9
试剂准备.....	9
操作步骤.....	11
操作流程图.....	12
操作要点提示.....	13
结果判断.....	13
结果重复性.....	15
灵敏度.....	15
特异性.....	16
常见问题分析及解决办法.....	17
相关产品.....	19
参考文献.....	20
实际加样情况表.....	22

H	G	F	E	D	C	B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

实际加样情况表

浓缩生物素化抗体稀释方法

所用板条数	浓缩生物素化抗体	+	生物素化抗体稀释液
12	110 μ L	+	10890 μ L
10	90 μ L	+	8910 μ L
8	70 μ L	+	6930 μ L
6	50 μ L	+	4950 μ L
4	33 μ L	+	3267 μ L
2	17 μ L	+	1683 μ L
1	9 μ L	+	891 μ L

浓缩酶结合物稀释方法

所用板条数	浓缩酶结合物	+	酶结合物稀释液
12	110 μ L	+	10890 μ L
10	90 μ L	+	8910 μ L
8	70 μ L	+	6930 μ L
6	50 μ L	+	4950 μ L
4	33 μ L	+	3267 μ L
2	17 μ L	+	1683 μ L
1	9 μ L	+	891 μ L

简介:

最初通过筛选人胎盘cDNA文库发现了血管内皮生长因子受体-1 (VEGF R1, 也称为Flt-1)。它是对血管生成因子VEGF (VEGF-A), PIGF和VEGF-B的特异性受体酪氨酸激酶 (RTK)。VEGF R1通过前mRNA水平的可变剪接以两种形式表达: 能够转导信号的全长的膜结合受体; 和能够螯合配体或与全长受体二聚化和阻止信号转导的截短的可溶性受体 (sVEGF R1)。尽管VEGF R1无效突变是致死的, 但是激酶结构域的缺失不是, 这表明VEGF R1的可溶形式或至少细胞外结构域是正常血管发育所必需的。sVEGF R1的实验和临床应用已经成功地用于预防新血管生成和肿瘤生长。sVEGF R1的血清/血浆水平可能随病理而变化, 并且可能具有预后价值 (prognostic value)。已经表明sVEGF R1水平应当在实验和病理条件中与VEGF水平一起呈现。据报道, 高水平的sVEGF R1在怀孕期间和原发性高血压患者的血浆中发生。在心血管疾病患者和吸烟者的血浆中观察到很低的水平。

人VEGF R1基因产生3.0kb和2.4kb的两个主要转录物, 分别对应于全长受体和可溶性受体。全长VEGF R1是以7个胞外免疫球蛋白 (Ig) 样结构域, 膜扫描区和包含激酶插入序列的细胞内酪氨酸激酶结构域为特征的约180kDa糖蛋白。截短的sVEGF R1仅由前六个胞外Ig样结构域组成。配体结合发生在前三个N末端Ig样结构域内, 而第四个Ig样结构域负

受体二聚化,这是通过转磷酸化激活的先决条件。除了同二聚体,VEGF R1还可以与VEGF R2形成活性异源二聚体。VEGF R1的可溶形式与VEGF R2能形成无活性的异源二聚体。

VEGF R1在血管生成过程中的确切作用是有争议的。VEGF R1对VEGF具有比VEGF R2更大的亲和力,而且在配体结合时,VEGF R2被磷酸化约10倍与VEGF。VEGF刺激VEGF R2转染的驱化性和增殖,而不能刺激VEGF R1转染导致的人脐静脉和猪主动脉内皮细胞的趋化性和增殖。缺失受体的敲除小鼠通常在第10天死亡。缺乏VEGF R2导致未发育的血管系统和少数成熟内皮细胞,而缺乏VEGF R1导致内皮细胞聚集成无序小管的优势。然而,只缺乏VEGF R1的酪氨酸激酶结构域的小鼠在接近正常的脉管系统下存活。这些观察结果支持以下结论:VEGF R1发挥作用以限制VEGF / VEGF R2介导的血管生成,完整受体作为诱饵,可溶形式通过与VEGF R2二聚化或螯合游离配体产生惰性受体。然而,有证据表明,VEGF R1的酪氨酸激酶结构域确实发挥血管生成作用。VEGF R1 / R2的异源二聚体可以转导信号。VEGF诱导的一氧化氮(NO)释放似乎由VEGF R1介导,并且该NO释放反过来充当分子开关,抑制VEGF R2介导的增殖并且影响内皮细胞再分化成毛细血管样结构。此外,VEGF和PIGF介导的单核细胞/巨噬细胞的迁移和组织因子的产生似乎由VEGF R1介导。

参考文献:

1. Shibuya, M. et al. (1990) *Oncogene* 5:519.
2. Maglione, B. et al. (1991) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 88:9267.
3. Kendall, R.L. et al. (1994) *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 201:326.
4. Sawano, A. et al. (1996) *Cell Growth Differ.* 7:213.
5. Olofsson, B. et al. (1996) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 93:2576.
6. Kendall, R.L. et al. (1993) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90:10705.
7. Kendall, R.L. et al. (1996) *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 226:324.
8. Shalaby, F. et al. (1995) *Nature* 376:62.
9. Fong, G.H. et al. (1995) *Nature* 376:66.
10. Hiratsuka, S. et al. (1998) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:9349.
11. Yang, W. et al. (2001) *Cancer Res.* 61:7840.
12. Stechschulte, S.U. et al. (2001) *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 42:1975.


相关产品:

目录号	产品名称	目录号	产品名称
CHE0101	Human IL-1 α ELISA Kit	CHE0029	Human TGF- β 1 ELISA Kit
CHE0001	Human IL-1 β ELISA Kit	CHE0103	Human MCP-1 ELISA Kit
CHE0003	Human IL-2 ELISA Kit	CHE0044	Human EGF ELISA Kit
CHE0027	Human IL-2sR α ELISA Kit	CHE0025	Human G-CSF ELISA Kit
CHE0028	Human IL-3 ELISA Kit	CHE0026	Human GM-CSF ELISA Kit
CHE0005	Human IL-4 ELISA Kit	CHE0052	Human sICAM-1 ELISA Kit
CHE0006	Human IL-5 ELISA Kit	CHE0053	Human Leptin ELISA Kit
CHE0009	Human IL-6 ELISA Kit	CHE0043	Human VEGF ELISA Kit
CHE0011	Human IL-8 ELISA Kit	CHE0060	Human FGF basic ELISA Kit
CHE0012	Human IL-9 ELISA Kit	CHE0105	Human MMP-9 ELISA Kit
CHE0013	Human IL-10 ELISA Kit	CHE0107	Human TIMP-1 ELISA Kit
CHE0016	Human IL-12p40 ELISA Kit	CHE0112	Human GDF-15 ELISA Kit
CHE0015	Human IL-12p70 ELISA Kit	CHE0059	Human TSLP ELISA Kit
CHE0055	Human IL-15 ELISA Kit	CHE0035	Human Resistin ELISA Kit
CHE0054	Human IL-17 ELISA Kit	CHE0021	Human Adiponectin ELISA Kit
CHE0056	Human IL-21 ELISA Kit	CHE0033	Human Proinsulin ELISA Kit
CHE0057	Human IL-22 ELISA Kit	CHE0085	Human IL-24/MDA-7 ELISA Kit
CHE0058	Human IL-32a ELISA Kit	CHE0086	Human PBEF ELISA Kit
CHE0017	Human IFN- γ ELISA Kit		
CHE0019	Human TNF- α ELISA Kit		
CHE0024	Human APO-1/FAS ELISA Kit		

如需其它试剂盒, 请致电四正柏生物!

检测原理:

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗人 VEGF R1/Flt-1 单克隆抗体预包被酶标板, 加入适度稀释的样本和标准品, 其中的 VEGF R1/Flt-1 会与其单抗结合, 洗去游离成分; 加入生物素化的抗人 VEGF R1/Flt-1 抗体, 抗人 VEGF R1/Flt-1 抗体与结合在单抗上的人 VEGF R1/Flt-1 结合而形成免疫复合物, 洗去游离的成分; 加入辣根过氧化物酶标记的亲合素, 生物素与亲合素特异性结合, 洗去未结合的酶结合物; 加入显色剂, 若反应孔中有 VEGF R1/Flt-1, 辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色; 加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值, VEGF R1/Flt-1 浓度与 OD450 值之间呈正比, 可通过绘制标准曲线计算出标本中 VEGF R1/Flt-1 浓度。

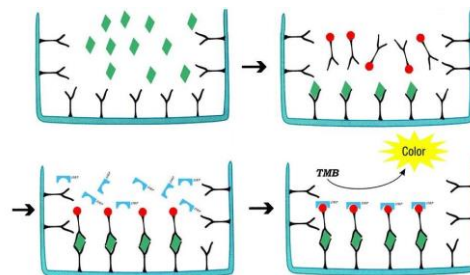

检测原理示意图

试剂盒组成:

试剂盒组成	96t	48t	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
2a 浓缩生物素化抗体	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
2b 生物素化抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶结合物（避光）	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶结合物稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂（避光）	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

问题	可能原因	解决办法
全部板子变成规则的蓝色	不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的 HRP 仍有残留	最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗涤液或加样量是否准确
	太多的酶结合物	检查稀释度，必要时进行效价测定
	封板膜或试剂容器被重复使用，导致 HRP 残留，使 TMB 底物产生非特异蓝色	使用新封板膜，每步使用不同的试剂容器
高 CV 值花板	操作不慎或洗涤不充分	按说明书洗板、加样和显色，洗板尤为重要
	出现干板，没有使用封板膜、封板膜重复使用	确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜封口，注意每步使用新鲜的封板膜
	移液器不准确，吸头重复使用	检查并校准移液器，每次取样必须更换吸头
标准曲线可得到，但两点之间区别很差（低或平的曲线）	酶结合物不足	检查稀释度，必要时进行效价测定
	检测抗体不足	检查稀释度，必要时进行效价测定
	板子显色不足	延长底物孵育时间 使用推荐品牌的底物溶液
标准曲线很好，但没有任何期望的阳性信号	标本中无相应的待检测物质	使用内参对照 重复实验，重新考虑实验的相应参数
	标本基质遮盖检测	将标本至少做 1:2 相应的稀释，或进行系列稀释
标准曲线很好，但标本的判读值很高	标本中含的待检物质水平超过实验范围	稀释标本
边缘效应	工作环境温度不均衡	避免将板子在变化温度环境中孵育
漂移	实验过程中出现间断	整个实验应连续操作，在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。
	试剂没有按说明书平衡至室温	在所有试剂加入孔前，确保它们已平衡至室温，除非说明书中有另外的要求。
是否可更改试剂盒所提供的操作步骤？		一般厂商为确保最高的灵敏度，对试剂盒都进行了优化，为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。
是否可混用不同批次试剂盒中的试剂？		不可以，绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的，若有问题可与厂家或代理商联系。
是否可增加或减少标本的体积？		商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的，应按说明书操作，不建议更改所加标本体积。
是否可重新确定自己的标准曲线的点？		可以。说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度，可改变稀释倍数和增加曲线的点，但是必须在实验范围内，高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。

ELISA检测常见问题分析及解决办法:

问题	可能原因	解决办法	
无颜色	不同试剂盒或不同批号的试剂混合	重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。	
	漏加酶	检查操作流程, 注意不要漏加	
	HRP 酶污染了叠氮钠	使用新配制的试剂, 禁含叠氮钠	
	试剂配制/使用有误	重做试验, 严格按说明书操作, 每次配制和使用前看清标签	
显色弱	超过有效期的产品可能会产生很弱的信号	检查产品有效期	
	缩短孵育时间能使实验信号变弱	检查孵育时间	
	使用了被污染的试剂	检查试剂是否被污染	
	仪器设定不正确, 滤光片不匹配	仪器是否设定正确, 滤光片的使用等	
	洗涤操作不规范	洗涤不充分, 使用手工洗板常出现	洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 倾出时应迅速
			若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量。板内侧不应接触设备
		检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确	
		可在两次洗板之间加 30 秒的浸泡	
高背景	实验中孵育温度和时间不适当	确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当	
	酶加量过多	加酶前验看移液器调节量是否准确 检查稀释度, 若必要进行效价测定	

储存条件:

未启封的试剂盒		4℃保存, 请于保质期内使用。
已启封或重新溶解的试剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。 2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需用现配。
	2a 浓缩生物素化抗体 (100×)	
	2b 生物素化抗体稀释液	
	3a 浓缩酶结合物 (避光 100×)	
	3b 酶结合物稀释液	
	4 浓缩洗涤液 20×	
	显色剂 (避光)	
	终止液	4℃或常温保存
	标准品	重溶后分装, -20℃存放一个月, 避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃, 不得重复使用。
	抗体包被板条	实验中不用的板条应立即放回包装袋中, 密封干燥 4℃保存。

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

其它实验材料(不提供, 但可协助购买):

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10,2-20,20-200,200-1000 μ l。
一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37 $^{\circ}$ C温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒


注意事项:

1. 试剂盒保存在2-8 $^{\circ}$ C, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. **不同批号试剂不可混用。**
4. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
5. 终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。

特异性:

此试剂盒可检测天然和重组的人VEGF R1/Flt-1, 以50ng/ml平行做特异性试验, 均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组人细胞因子	重组小鼠细胞因子
PlGF	VEGF R1/Fc Chimera
VEGF	
VEGF121	
VEGF167	
VEGF/PlGF	
VEGF R2/Fc Chimera	
VEGF R3/Fc Chimera	

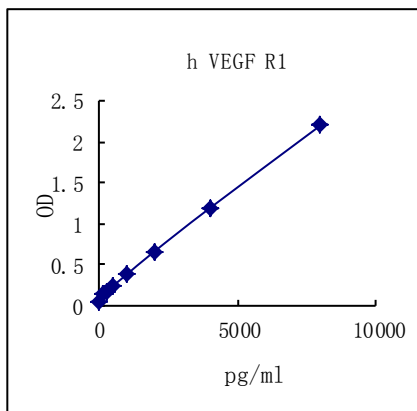

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

结果重复性:

板间，板内变异系数均 $<10\%$ 。

灵敏度:

最低检测人 VEGF R1/Flt-1 剂量小于 62pg/ml 。最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

6. 使用干净的塑料容器配制洗涤液，使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
7. 洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
8. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分，不同批号的试剂盒组份不能混用，请在有效日期内使用本产品。
9. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
10. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
11. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
12. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100、1:10、1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
13. 标准品稀释液，操作人，移液方式，洗涤方法，孵育时间及温度，试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
14. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

样品收集、处理及保存方法:

1. **血清:** 使用不含热原和内毒素的试管, 收集血液后, 室温凝血30min, 1000×g离心10min, 小心分离血清。
2. **血浆:** 用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆, 收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。
3. **细胞上清液:** 1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存:** 若样品不立即检测, 请将其按一次用量分装, -20℃—-70℃保存, 避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒, 检测前先离心或过滤去除; 室温下解冻, 请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释:** 可根据实际情况, 将标本做适当倍数稀释(建议做预实验, 以确定稀释倍数)。

试剂准备:

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒, 平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液:** 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶, 这属于正常现象, 加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。

3. 若标本 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
4. 参考数据:

标准品浓度 (pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.039	0.041	0.040	——
125	0.126	0.129	0.127	0.087
250	0.158	0.162	0.160	0.120
500	0.231	0.235	0.233	0.193
1000	0.373	0.376	0.374	0.334
2000	0.644	0.670	0.657	0.617
4000	1.190	1.187	1.188	1.148
8000	2.196	2.210	2.203	2.163

数据仅供参考, 不同用户最佳显色时间会有所不同

操作要点提示:


1. 配制各种试剂时要充分混匀, 但要避免产生大量泡沫, 以免加样时加入大量的气泡, 产生加样误差。
2. 为避免交叉污染, 在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
3. 为了确保准确的结果, 在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
4. 显色剂在添加之前, 应保持无色, 请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要, 肉眼可见前 3-4 孔有梯度蓝色, 后 3-4 孔差别不明显, 零孔无蓝色出现即可终止。
5. 每次检测均要做标准曲线, 根据样品待测因子的含量, 适当稀释或浓缩样本, 最好做预实验。

结果判断:

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值, 如果做复孔, 求其平均值。
2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y), 相应的VEGF R1/Flt-1标准品浓度为横坐标(X), 生成相应的标准曲线, 样品的VEGF R1/Flt-1含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。

3. **标准品:** 加入标准品/标本稀释液(1b)1.0ml至冻干标准品(1a)中, 待彻底溶解后, 静置15分钟混匀(浓度为8000pg/ml), 然后根据需要进行稀释, 见下图(建议标准曲线使用以下浓度: 8000、4000、2000、1000、500、250、125、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用, 未用完的标准品应按照一次用量分装后, 将其放在-20~-70℃贮存, 一次性使用, 避免反复冻融。

标准品稀释方法:

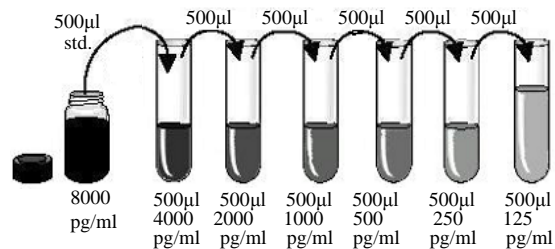

4. **生物素化抗体工作液:** 根据每孔需要100µl来计算总的用量, 多配制100-200µl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法参照“第21页”)
5. **酶结合物工作液:** 以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法参照“第21页”)

操作步骤:

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 μ l /孔)加入相应孔中（零孔只加标准品/样本稀释液），用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育90分钟（空白对照孔除外）。
3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 μ l，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 μ l，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
4. 加入生物素化抗体工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育60分钟（空白对照孔除外）。
5. 洗板4次。
6. 加入酶结合物工作液(100 μ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育30分钟（空白对照孔除外）。
7. 洗板4次。
8. 加入显色剂100 μ l /孔，避光，37 $^{\circ}$ C孵箱孵育10-20分钟。
9. 加入终止液100 μ l /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

操作流程:

